Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
DRÄGERWERK A.G. Lübeck

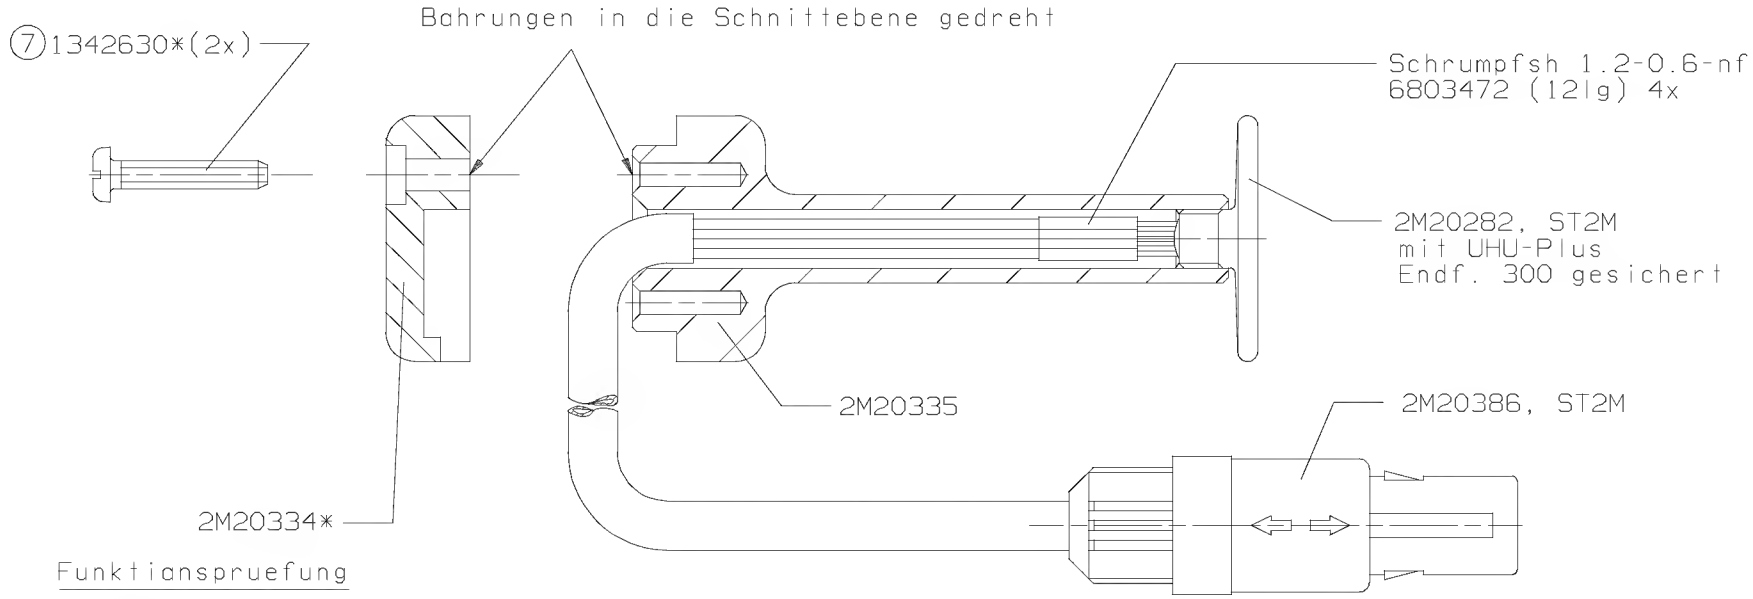

Funktianspruefung

-Messung des Widerstandswertes zwischen Steckerbuchsen 1+2, sawie zwischen 4+5
-Widerstandswert ablesen und nach unterstehender Tabelle den Temperaturwert ermitteln.
-Vergleich des ermittelten Temperaturwertes mit der Raumtemperatur. Zulaessige Abweichung:±1°C.

T (°C)	R(Ω)	T (°C)	R(Ω)
15	7854,70	23	5460,90
16	7498,50	24	5224,70
17	7160,50	25	5000,00
18	6839,70	26	4786,10
19	6535,20	27	4582,50
20	6246,00	28	4388,80
21	5970,80	29	4204,40
22	5709,40	30	4028,70

Isalatianspruefung 200 V DC

Die Pruefspannung ist anzulegen zwischen den Steckerpins 1 und 4
1 und 3
4 und 3

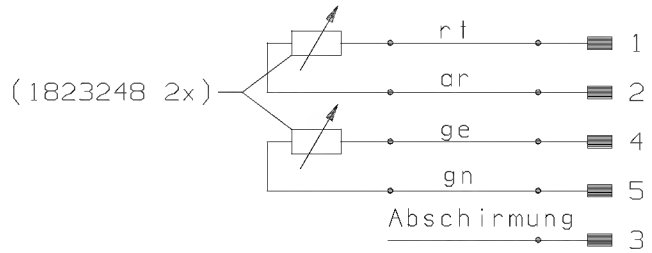

* Lose Teile

verpackt in Flachbeutel mind. 200x240 DWN 1210

ST2M20277

=OA= --	=OB= --	=QC= --				
Werkstoff ---			07	1x	DIN Teil geaendert 11.06.97/Sti.	
					(37/97)	
			Aend Ziffer	kommt vor	Aenderungen	
Maszstab 2:1	Allgemeintoleranzen ---	Abteilung M2	1994	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger
			Bearb	27.10.	OLLMANN	
			Gepr.	27.10.	OLLMANN	
				--	--	
		Benennung Sensor, vollst.			Zeichnungs-Nr. 2M20277	
					Ersatz fuer 2M20277-06	
PROO	CADRA=8				Ersetzt durch	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
DRÄGERWERK AG Lübeck

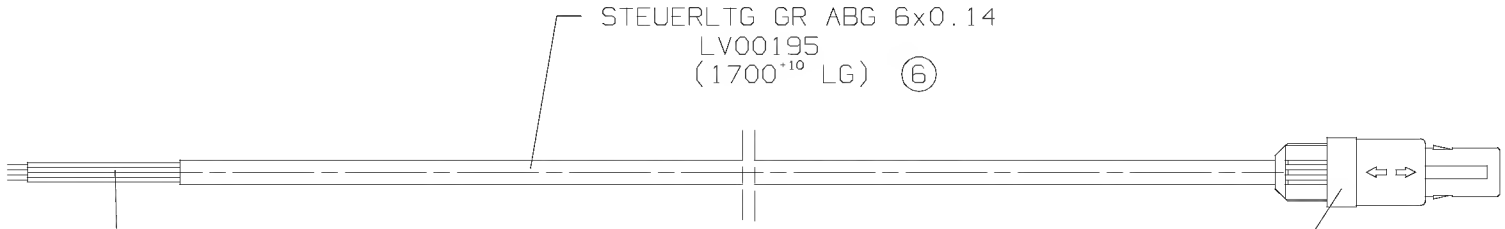

ADERENDEN 4±1 ABISOLIERT UND VERZINNT

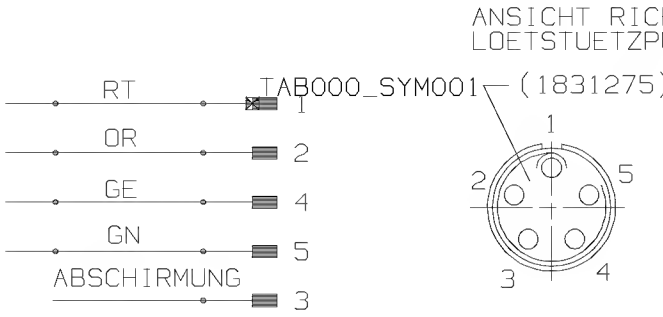

ST 2M20386

=OA= - -	=OB= - -	=QC= - -					
Werkstoff - - -			6	1X	KABELLAENGE GEAEND.		
			Aend Ziffer	kommt vor	Aenderungen		
Maszstab 1 : 1	Allgemeintoleranzen - - -	Abteilung M2	1992	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger	
			Bearb	03.08.	OLLMANN		
			Gepr.				
INFO	CADRA	Benennung Kabel				Zeichnungs-Nr. 2M20386	
						Ersatz fuer 2M20386"5"	
						Ersetzt durch	